



Laboratoire pharmaceutique de fabrication N° F 89/37

Z.I. de la Tuilerie - 60290 Neuilly-sous-Clermont
Tél. : 03 44 73 83 60
Fax : 03 44 73 57 32
e-mail : euromedis@wanadoo.fr

GANT D'EXAMEN LATEX SANS POUDRE MEDICLEAN SURFACE RUGUEUSE

I - DESCRIPTION

Gants ambidextres sans poudre existent en 5 tailles T 5/6 - T 6/7 - T 7/8 - T 8/9 - T XL, conformes aux normes EN 455-1 et EN 455-2. - **MARQUAGE CE**

II - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Origine : Malaisie

Taille	Périmètre en mm de la paume	Longueur en mm	Epaisseur en µm d'un doigt	Epaisseur en µm de la paume
T 5/6	160	240	220	170
T 6/7	170	240	220	170
T 7/8	190	240	220	170
T 8/9	200	240	220	170
T XL	210	240	220	170

Résistance à la traction : 27 Mpa - Après vieillissement artificiel 168 H 70° - 17 Mpa

Force minimale à la rupture : 9 N

Allongement à la rupture : 875 % - Après vieillissement artificiel 168 H 70° - 650 %

Résistance au déchirement de la manchette : 465 %


Etanchéité : contrôle unitaire des gants à l'air et contrôle statistique à l'eau selon la norme EN 455-1 - **AQL = 1.5**



FICHE TECHNIQUE - 01/2002
GANT LATEX SANS POUDRE MEDICLEAN SURFACE RUGUEUSE 1/3

Banque Scalbert Dupont - BNP - N° Siret 333 061 711 00037 - Code APE 514 N

TRAITEMENT HORS LIGNE DE PRODUCTION

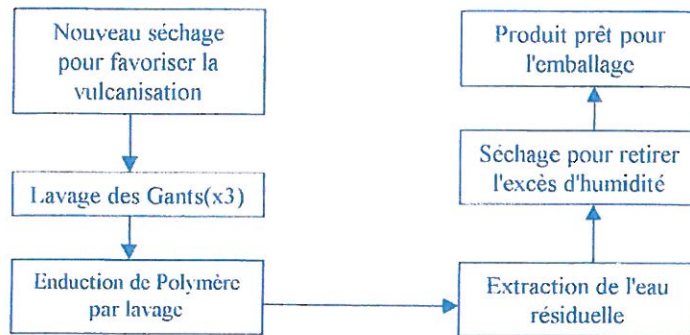

IV - COMPOSITION

- Latex
- Oxyde de zinc
- Poudre de sulfure
- Dioxyde de titanium
- Zinc dithiocarbamate
- Phénol
- Hydroxyde de potassium

Taux de Protéine : < 20 µg/g (Méthode LOWRY) Contrôle lot par lot


V - CONDITIONNEMENT

Boîte de 100 /carton de 1000

T 5/6	REF. 127510
T 6/7	REF. 127511
T 7/8	REF. 127512
T 8/9	REF. 127513
T XL	REF. 127514

III - FABRICATION DES GANTS

FABRICATION DES GANTS LATEX SANS POUVRE.

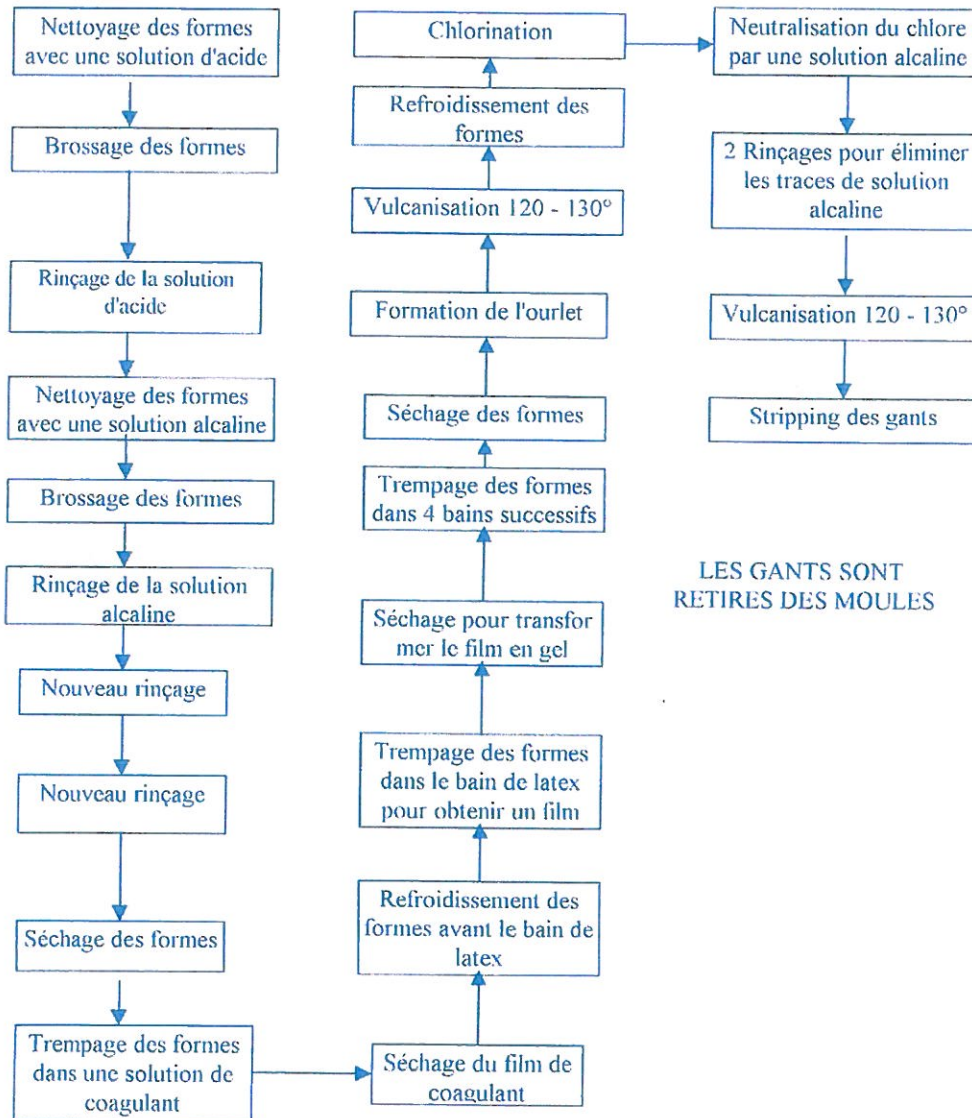



Laboratoire pharmaceutique de fabrication N° F 89/37

Z.I. de la Tuilerie - 60290 Neuilly-sous-Clermont

Tél. : 03 44 73 83 60

Fax : 03 44 73 57 32

e-mail : euromedis@wanadoo.fr

**DECLARATION CE DE CONFORMITE
CONFORMEMENT A L'ANNEXE VII DE LA
DIRECTIVE 93/42 CEE**

Nous, les LABORATOIRES EUROMEDIS, déclarons sur l'honneur que le Dispositif de CLASSE I :

**GANT D EXAMEN LATEX SANS POUDDRE RUGUEUX
MEDICLEAN
REF 127510/511/512/513/514**

est conforme aux exigences de la Directive Européenne 93/42 CEE du Conseil du 14 JUIL 1993 et au livre V bis du Code de la Santé Publique à partir du lot 90401871.

Le dispositif satisfait aux exigences essentielles de l'Annexe I.

Nous tenons à votre disposition le dossier technique correspondant.

Fait à Neuilly Sous Clermont

le 23.6.99

N. POINTEAU
Responsable Assurance Qualité
Pharmacien Responsable

